स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
अधिष्ठाता यांचे कार्यालय

जा.क्र./शावैमरुअं/सा.भांडार/ 1213/२०२० क 9/ ३/२०२१

विषय:- यंत्रसामुग्री व उपकरणांचे दरपत्रके सादर करणे बाबत..
संदर्भ : - दिनांक :- /१/२०२१ रोजीची मंजुर टिपणी

उपरोक्त विषयी आपणास कळविण्यात येते की, कोविड १९ च्या अनुषंगाने २५० बेडेड डेडीकेटेड हॉस्पीटलसाठी मा.जिल्हाधिका, बीड यांनी मंजुर केलेल्या अनुदानातुन खालील साहित्याची खरेदी करावयाची असल्याने खालील यंत्रसामुग्री व उपकरणांचे दरपत्रके या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत.

दरपत्रके सादर करतांना मोहरबंद दरपत्रके मा.अधिष्ठाता ,स्वमी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई यांच्या नावे सादर करण्यात यावीत. तसेच सदरील साहित्यांचे दरपत्रक सादर करण्यासाठी अतिम दिनांक ९/३/२०२१ रोजी दुपारी ५.०० वाजेपर्यत असुन प्राप्त झालेली दरपत्रके दिनांक १० / ३ /२०२१ रोजी प्रशासकीय कार्यालयात खरेदी समिती समक्ष उघडण्यात येतील

अ.क्र.	यंत्राचे नांव	नग
१	COLAGULOMETER SINGLE CHANAL	१
२	PLUS OXIMITER	१

<u>अटी व शर्ती</u>

१. दरपत्रक धारकाने मुबंई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ नुसार दुकानाचे शासन मान्य नोंदणी प्रमाणपत्र छांयाकीत प्रत दरपत्रकासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.
२. दरपत्रक धारकाकडे सुक्षम,लघु व मध्यम उद्योगक मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे नोंदणी केलेले उद्योग आधार प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
३. दरपत्र धारकाच्या दुकानाचे नाव,संपुर्ण पत्ता,नोंदणी क्रमांक,जीएसटीनंबर व पॅन नंबर असलेल्या दुकानाच्या लेटर पॅडवर सही व शिक्का असलेली दरपत्रके सदर साहित्याच्या अ.क्रमांक यादीनुसार सादर करण्यात यावी,तसेच ज्या साहित्यांचे दर उपलब्ध होऊ शकत नाहित त्या साहित्याच्या दराच्या ठिकाणी एन. ए. (NA)नमुद करावे.

   दरपत्रका सोबत शासन मान्य जीएसटी प्रमाणपत्र,फर्मच्या नावाचे किवा प्रोप्रायटरच्या नावचे पॅन कार्डची छांयाकीत प्रत तसेच एकल दरपत्रक धारक असल्याचे स्वत: स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.सदर प्रमाणपत्र नमुना देण्यात आलेला आहे.
४. दरपत्रकातील साहित्यांचे दर शासन नियमानुसार सर्व करांसहीत बाजार भावापेक्षा जास्त दराचे सादर करण्यात येऊ नये.तसेच सर्व साहित्य स्वत: स्वखर्चाने दहा दिवसांच्या आत पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.तसेच वाहतुक खर्च किवा इतर कोणताही जादा खर्च देण्यात येणार नाही.
५. मागविण्यात आलेल्या साहित्यांचे दरपत्रक प्रमाणित झाल्याच्या दिनांकापासुन सहा (०६) महिन्यापर्यत वैध राहतील.

६. प्रशासकीय कारणास्तव देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क किंवा व्याज देण्यात येणार नाही.

७. पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य वैध कालावधीचे व चांगल्या प्रतीचे असावे. हलके किंवा निकृष्ट दर्जाचे असल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहील.

८. तसेच अपुर्ण माहितीसह व प्रमाणपत्रा शिवाय साद केलेली संबंधीतांची दरपत्रके विना स्पष्टीरण नाकारण्यात येतील तसेच प्रशासकिय कारणास्तव किंवा निधी अभावी काही अडचण निमा्रण झाल्यास साहित्य खरेदी बाबत सदरच्या दरपत्रकाची संपुर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकारी अधिष्ठाता यांना राहिल.

९. पुरवठादाराने दरपत्रके सादर करतांना मागील दोन वर्षाचे इनकमटॅक्स रिटर्न,जीएसटी रिटर्न, इतर मेडीकल कॉलेज व रुग्णालयास instrument आणि equipment चा पुरवठा केल्याचे आदेशाची छायांकीत प्रत, तसेच मागील तीन वर्षाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र इत्यांदींच्या छायांकीत प्रत दरपत्रका सोबत सादर कराव्यात.तसेच दरपत्रक सिलंबद लिफाफयात सादर करावयाचे दस्ताऐवज (DOCUMENT) :- अधिकृत लेटरहेड वर दरपत्रक सादर करावे १.दुकानाचा परवाना २.जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्र ३. पॅनकार्डची प्रत ४. अनुभव प्रमाणपत्र (शासकीय कार्यालयाचे ३ पुरवठा आदेश) ५. वस्तु/यंत्रसामग्री /उपकरणे/साधनसामग्रीचे माहीतीपत्रक,कॅटलॉग /ब्राउचर्स यांची मुळ प्रत ६. आय.एस.ओ./आय.एस.आय. प्रमाणपत्र ७. पुरवठादार हा अधिकृत विक्रेता असल्याचे संबंधीत कंपनीचे अधिष्ठाता यांचे नावे असलेले प्रमाणपत्र (सोबत नमुन्याची प्रत संलंग्न) ८. प्रत्येक पुरवठाधारकास केवळ एक दरपत्रक सादर करता येईल. खरेदी प्राधिकाप्रमाणपत्र हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत तसेच एकल दरपत्रक देण्याबाबत हमीपत्र (Undertaking) व सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे प्रमाणप (सोबत प्रत संलग्न), उक्त सर्व दस्तऐवेज वैध (Valid)तसेच विहीत नमुन्यात असणे बंधनकारक असुन सर्व दस्ताऐवज सीलबंद लिफाफयामध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.सर्व दस्ताऐवज(Document Checklist) क्रमाने दरपत्रकासोबत संलग्नीत करावे. (सोबत अत्यावश्यक दस्ताऐवज पडताळणी सुची (DOCUMENT CHECKLIST) संलग्न.

१०. उपरोक्त प्रमाणे अटी व शर्ती मान्य असल्यासच सदरचे दरपत्रके सादर करावे.

अधिष्ठाता,
स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकिय
वैद्यकिय महाविद्यालय रुगणालय,अंबाजोगाई

प्रत : -

१. संस्थेची वेबसाईट,स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.व रुग्णालय,अंबाजोगाई.
२. नोटीस बोर्ड,महाविद्यालय विभाग, स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.व रुग्णालय,अंबाजोगाई.

HORIBA
Medical

Compact 2-channel instrument device dedicated for small laboratories to perform coagulation screening and DDimers tests

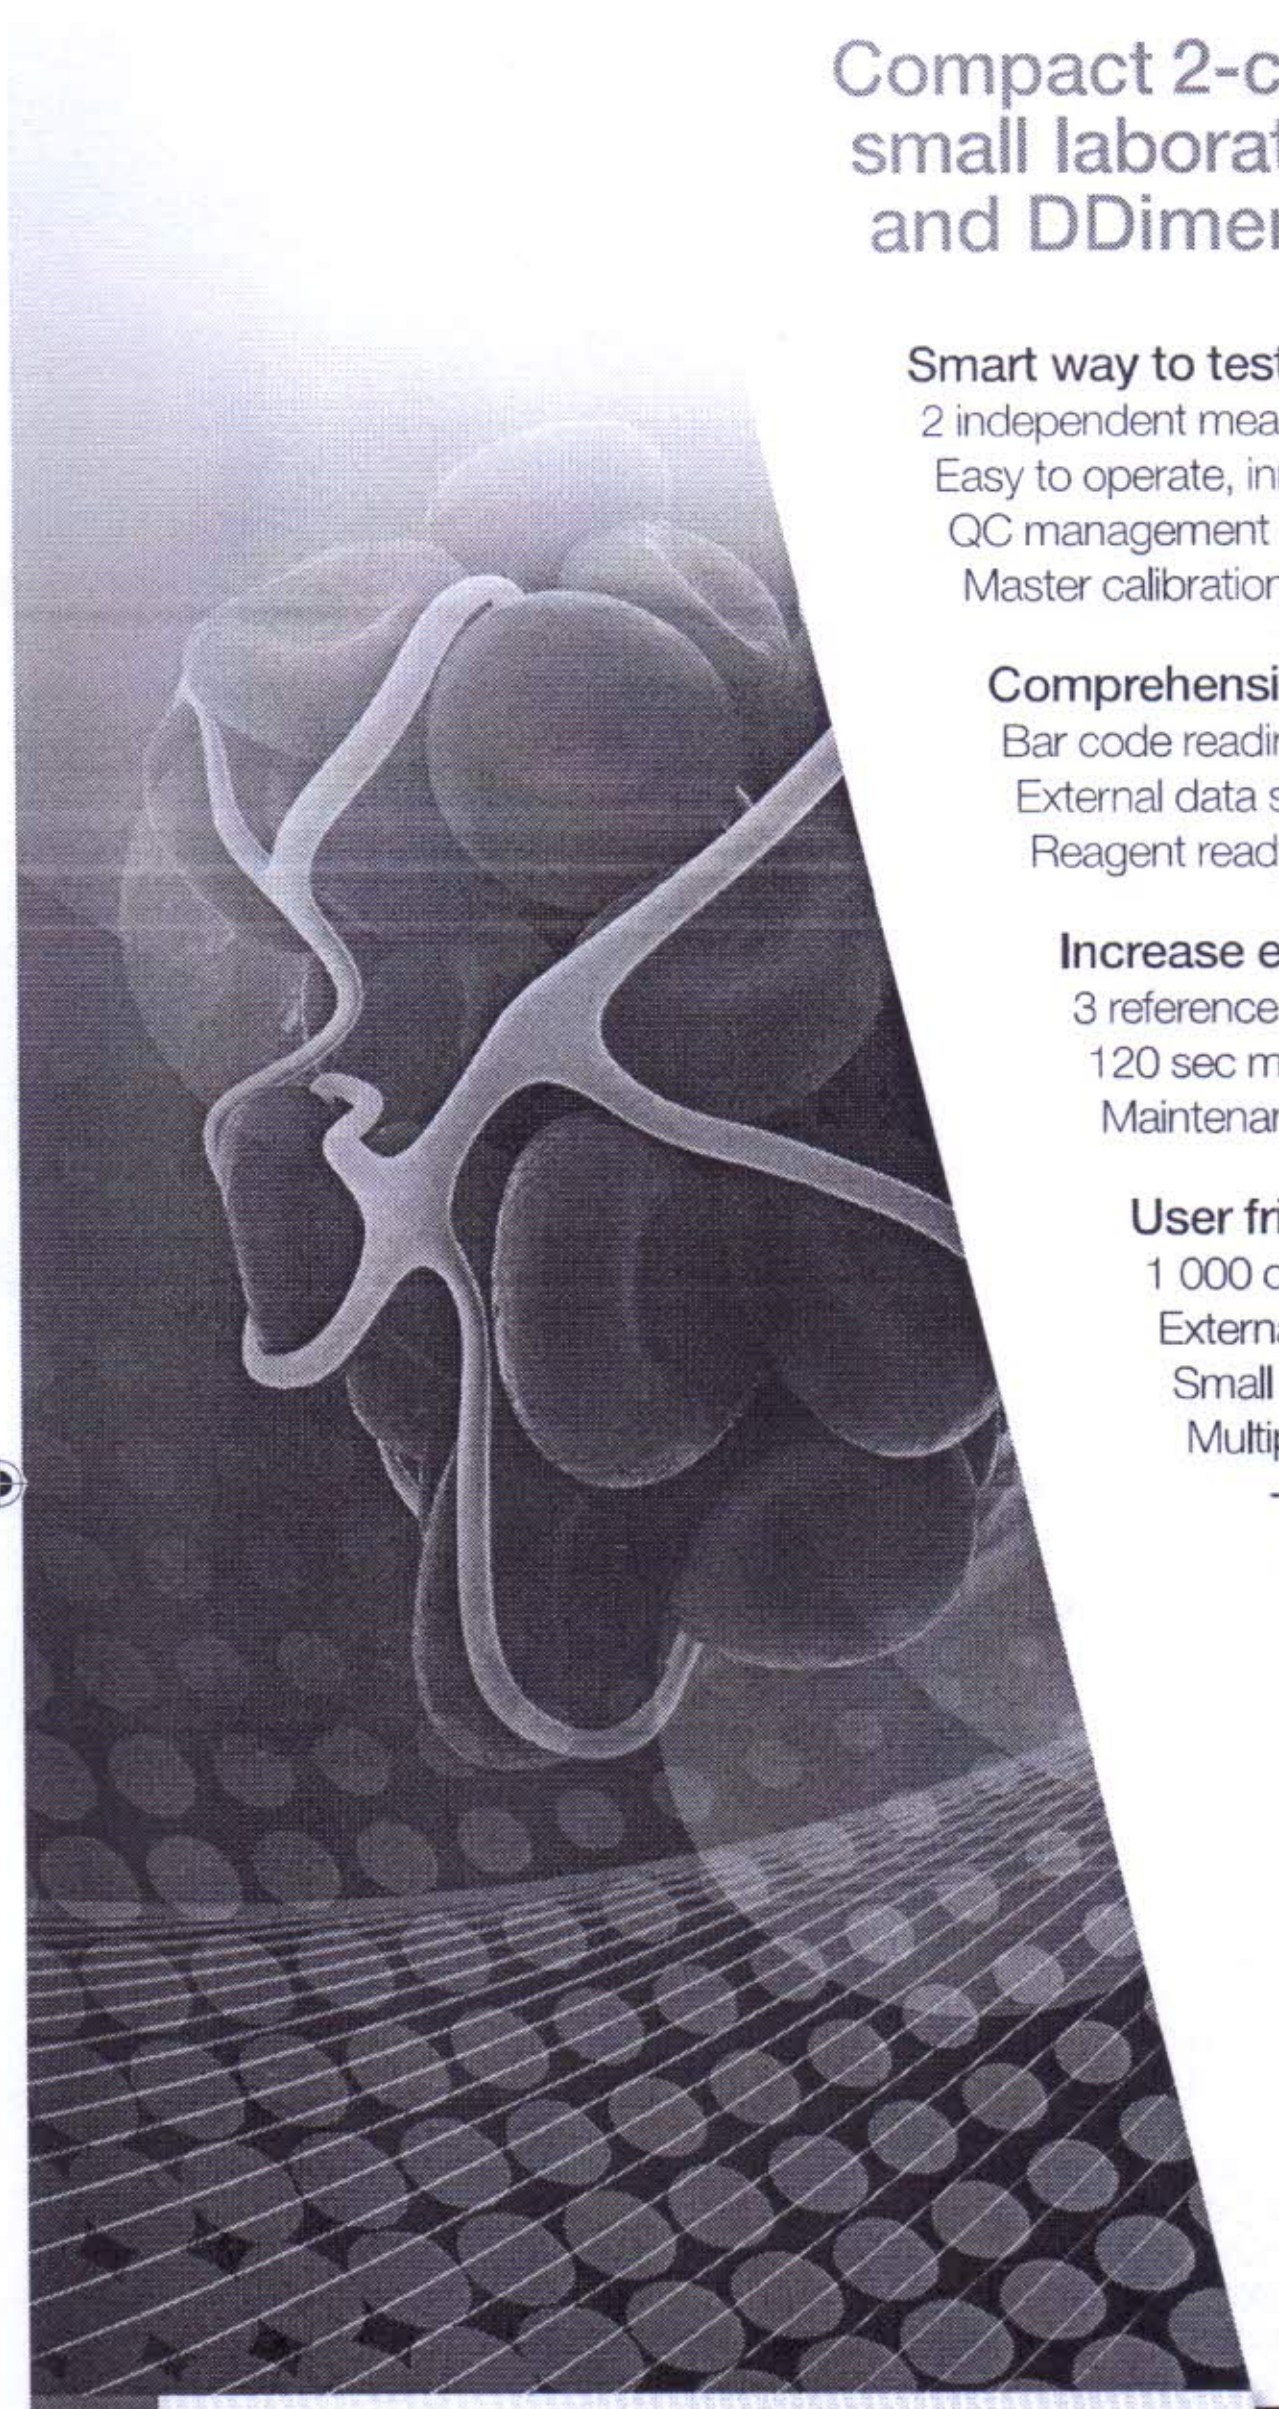

Smart way to test
2 independent measuring channels
Easy to operate, innovative user interface
QC management
Master calibration curve (no calibration needed)

Comprehensive security
Bar code reading capability
External data storage (USB device)
Reagent ready-to-use

Increase efficiency
3 reference measuring methods : clotting, turbidimetric and chromogenic
120 sec maximum measurement
Maintenance free

User friendly features
1 000 data storage capacity
External printer connectivity
Small footprint
Multiple connectivities
- Laboratory information system
- Optional Yumizen G data software

(signature) 25.2.21
Dr. S. D. Bisare.
i/c. Patho-Lab.

Yumizen G200

Yumizen G200

Dimensions & Weight:
Length : 102 mm, Height : 50, Depth : 165 mm, Weight : 0,4 kg

Throughput:
120 sec maximum measurement

Temperature:
15°C-30°C

Power:
100-240VAC, 47-63Hz, 25W
External power supply

Export:
2 x USB plug :
1 x Master USB connector : to connect an external printer, barcode reader or external storage device to the instrument.
1 x Slave USB connector : to connect the instrument to a computer as an external device.

Screen:
Color LCD touch screen 53 x 71 mm

Storage capacity:
1000 results

Parameter :
Clotting tests (640 nm)
Screening tests (PT, APTT, Fibrinogen, TT)
Factors (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Turbidimetric test (570 nm)
D-Dimer
Chromogenic test (405 nm)
ATIII

Consumables (kit) :

Yumizen G200	1 pc.
Power supply unit	1 pc
Magnetic mixer (2 pcs / set)	1 set
User Manual	1 pc

Norms:
EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002
EN ISO 13485 : 2003 and 2012
NF EN ISO 14971 - 2013

Directives:
98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30/EU (Electro Magnetic Compatibility)
2014/35/EU (Voltage limits)

Subject to modifications / Réf. flyer 1300038467 / YUMIZEN G200 © 2017 HORIBA Medical - HORIBA ABX SAS - France - RCS Montpellier 328 031 042

25.2.21
Dr. S.D. Borsare
I/C. Patho-Lab.

HORIBA
Medical
FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16
HORIBA Medical online : http://www.horiba.com/medical

Certified ISO9001/14001 OHSAS18001 ISO13485
Operating IMS
Apple Store Google play
PEFC
IMPRIM'VERT

HORIBA
Medical

Compact 2-channel instrument device dedicated for small laboratories to perform coagulation screening and DDimers tests

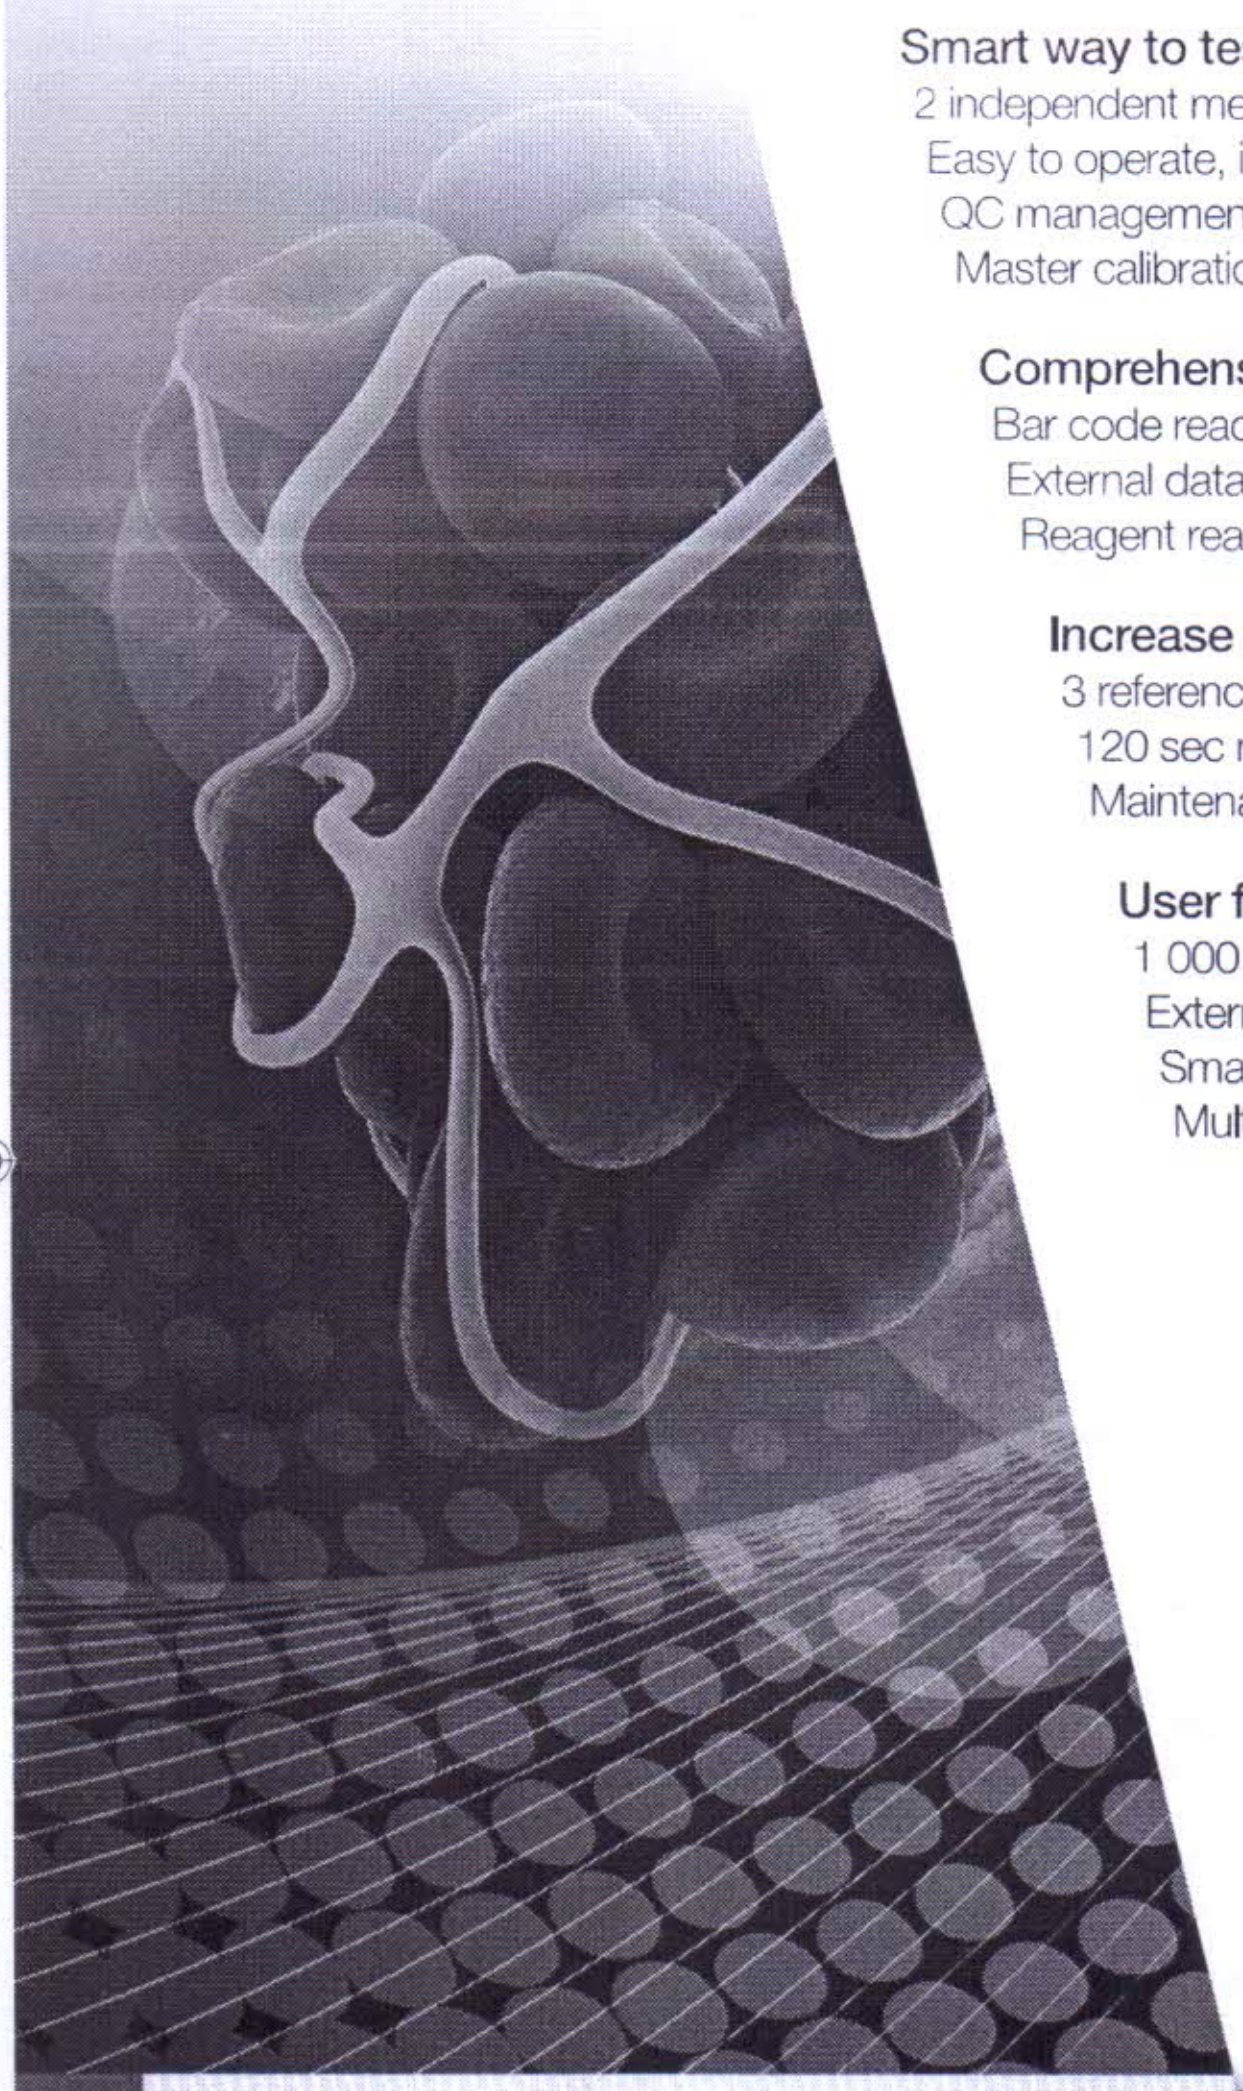

Smart way to test
- 2 independent measuring channels
- Easy to operate, innovative user interface
- QC management
- Master calibration curve (no calibration needed)

Comprehensive security
- Bar code reading capability
- External data storage (USB device)
- Reagent ready-to-use

Increase efficiency
- 3 reference measuring methods : clotting, turbidimetric and chromogenic
- 120 sec maximum measurement
- Maintenance free

User friendly features
- 1 000 data storage capacity
- External printer connectivity
- Small footprint
- Multiple connectivities
  - Laboratory information system
  - Optional Yumizen G data software

Yumizen
G200

Dr. S. D. Bisase.
25.2.21
i/c Patho. Lab.

Yumizen G200

Dimensions & Weight:
Length : 102 mm, Height : 50, Depth : 165 mm, Weight : 0,4 kg

Throughput:
120 sec maximum measurement

Temperature:
15°C-30°C

Power:
100-240VAC, 47-63Hz, 25W
External power supply

Export:
2 x USB plug :
1 x Master USB connector : to connect an external printer, barcode reader or external storage device to the instrument.
1 x Slave USB connector : to connect the instrument to a computer as an external device.

Screen:
Color LCD touch screen 53 x 71 mm

Storage capacity:
1000 results

Parameter :
Clotting tests (640 nm)
Screening tests (PT, APTT, Fibrinogen, TT)
Factors (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Turbidimetric test (570 nm)
D-Dimer
Chromogenic test (405 nm)
ATIII

Consumables (kit) :

Yumizen G200	1 pc.
Power supply unit	1 pc
Magnetic mixer (2 pcs / set)	1 set
User Manual	1 pc

Norms:
EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002
EN ISO 13485 : 2003 and 2012
NF EN ISO 14971 - 2013

Directives:
98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30/EU (Electro Magnetic Compatibility)
2014/35/EU (Voltage limits)

Subject to modifications / Réf. flyer 1300038467 / YUMIZEN G200 © 2017 HORIBA Medical - HORIBA ABX SAS - France - RCS Montpellier 328 031 042

25.2.2021
Dr. S. D. Bisare
I/c Patho Lab.

SPECIFICATION FOR PULSE OXYMETER

Main Feature :

Display with 2.4" (320 × 240) color TFT LCD and blue highlight LED
Visual and audible alarm for systolic Pressure (D/A) , Mean Pressure (MAP) , SpO2 and Pulse rate (PR) , and upper and lower limit of alarm can be set.
Unique Flash memory, storage for up to 2000 NIBP data or SpO2 data within 48 hours.

Technical Specification :

SpO2
Measurement Range : 0-100%
Resolution : 1%
Accuracy : 70-100 % ± 2% , 0.69% unspecified
Alarm Range : 0-100 %
PULSE RATE RANGE : 25 – 250 bpm
Resolution : 1bpm
Accuracy : ± 2bpm or ±2% (select larger)

NIBP
Method : Oscillometry
Operation mode : Manual / Automatic
Measurement Range : 10~270mmHg ± 10mmHg
Auto Measurement Time : 1~250minutes
Over Pressure Protection : yes
Alarm : systolic , diastolic & mean
Dimension : 240mm × 140mm × 162mm
Net weight : 1.6Kg

Scanned with CamScanner

दरपत्रक धारक अधिकृत विक्रेता/पुरवठादार/कंपनी यांचे लेटरहेड

Letter No. Date :

प्रति,
मा.अधिष्ठाता,
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय
महाविद्यालय व रुग्णालय,अंबाजोगाई

विषय : - एकल दरपत्रक सादर करणेसंबंधीचे हमीपत्र सादर करणेबाबत
(अट क्रं.(१०) मधील दस्ताऐवज क्रं.०७ प्रमाणे)
संदर्भ : - आपले दरपत्रक मागणी पत्र
क्रमांक.
दिनांक.

महोदय,

संदर्भाकीत दरपत्रक मागणी पत्रानुसार मागणी करण्यात आलेले एकल दरपत्रक सादर करण्यासंबंधीचे हमीपत्र मी खालील प्रमाणे सादर करीत आहे.

हमीपत्र (Undertaking)

यादवारे हमी देतो की, दरपत्रक प्रक्रीयेसाठी एकच दरपत्रक सादर करीत आहे. आमच्याच फर्मशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीच्या नावे किंवा अप्रत्यक्षपणे केवळ आम्हास लाभ होईल, अश्या प्रकारे दुसरे दरपत्रक दरपत्रकप्रक्रीयेमध्ये सादर केलेला नाही. तसेच माझा/आमचा आपल्या कार्यालयातील खरेदी प्रक्रीयेतील खरेदी प्राधिकाऱ्याशी कुठलेही हितसंबंध नाही.

उक्त बाब भविष्यात असत्य/खोटी आढळुन आल्यास,र्स्वस्वी जबाबदारी आमची राहील.नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीस मी /आम्ही पात्र असु. तदसंबंधी माझी/आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही. अशी यादवारे मी हमी देत आहे.

अधिकृत व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी,
शिक्का आणि मोहर
Authorized Person Name,
Signature
With Stamp and Seal

दरपत्रक धारक अधिकृत विक्रेता/पुरवठादार/कंपनी यांचे लेटरहेड

Letter No. Date :

प्रति,
मा.अधिष्ठाता,
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय
महाविद्यालय व रुग्णालय,अंबाजोगाई

विषय : - एकल दरपत्रक सादर करणेसंबंधीचे हमीपत्र सादर करणेबाबत
(अट क्रं.(१०) मधील दस्ताऐवज क्रं.०७ प्रमाणे)
संदर्भ : - आपले दरपत्रक मागणी पत्र
क्रमांक.
दिनांक.

महोदय,

संदर्भाकीत दरपत्रक मागणी पत्रानुसार मागणी करण्यात आलेले एकल दरपत्रक सादर करण्यासंबंधीचे हमीपत्र मी खालील प्रमाणे सादर करीत आहे.

<u>हमीपत्र (Undertaking)</u>

यादवारे हमी देतो की, दरपत्रक प्रक्रीयेसाठी एकच दरपत्रक सादर करीत आहे. आमच्याच फर्मशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीच्या नावे किंवा अप्रत्यक्षपणे केवळ आम्हास लाभ होईल, अश्या प्रकारे दुसरे दरपत्रक दरपत्रकप्रक्रीयेमध्ये सादर केलेला नाही. तसेच माझा/आमचा आपल्या कार्यालयातील खरेदी प्रक्रीयेतील खरेदी प्राधिकाऱ्याशी कुठलेही हितसंबंध नाही.

उक्त बाब भविष्यात असत्य/खोटी आढळुन आल्यास,र्स्वस्वी जबाबदारी आमची राहील.नियमानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीस मी /आम्ही पात्र असु. तदसंबंधी माझी/आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही. अशी यादवारे मी हमी देत आहे.

अधिकृत व्यक्तीचे नाव व स्वाक्षरी,
शिक्का आणि मोहर
Authorized Person Name,
Signature
With Stamp and Seal